



检测报告

委托单位

样品名称

规格

检测项目

检测依据

检测方法


检测地点

检测日期

检测人员

委托日期: 2025 年 03 月 25 日
2025 年 03 月 26 日


报告日期: 2025 年 04 月 17 日

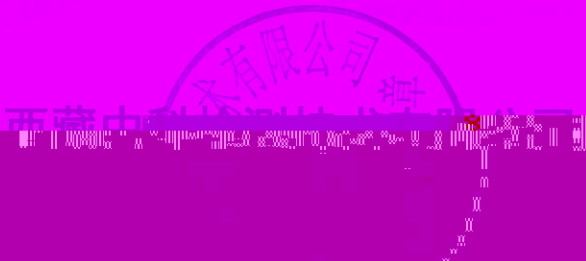

说 明

1、 报告无“骑缝章”及“CMA 章”和检测单位检测报告专用章无效。

- 1、 本检测报告仅供委托方内部使用，不得作为其他用途。
- 2、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品信息的真实性和完整性。
- 3、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的代表性和典型性。
- 4、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的稳定性和一致性。
- 5、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可追溯性和可验证性。
- 6、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可重复性和可再现性。
- 7、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可对比性和可参照性。
- 8、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可评价性和可判断性。
- 9、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可解释性和可说明性。
- 10、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可证明性和可证实性。
- 11、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可验证性和可确认性。
- 12、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可接受性和可认可性。
- 13、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可符合性和可 conformity。
- 14、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可满意性和可 satisfaction。
- 15、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可信任性和可 trust。
- 16、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可诚实性和可 honesty。
- 17、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可公正性和可 fairness。
- 18、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可透明性和可 transparency。
- 19、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可公开性和可 openness。
- 20、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可参与性和可 participation。
- 21、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可合作性和可 cooperation。
- 22、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可沟通性和可 communication。
- 23、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可协调性和可 coordination。
- 24、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可一致性和可 consistency。
- 25、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可统一性和可 uniformity。
- 26、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可标准化和可 standardization。
- 27、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可规范性和可 regulation。
- 28、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可约束性和可 constraint。
- 29、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可限制性和可 limitation。
- 30、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可控制性和可 control。
- 31、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可管理性和可 management。
- 32、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可组织性和可 organization。
- 33、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可计划性和可 planning。
- 34、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可实施性和可 implementation。
- 35、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可执行性和可 execution。
- 36、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可操作性和可 operation。
- 37、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可应用性和可 application。
- 38、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可推广性和可 promotion。
- 39、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可普及性和可 popularization。
- 40、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可传播性和可 dissemination。
- 41、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可交流性和可 exchange。
- 42、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可互动性和可 interaction。
- 43、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可参与性和可 participation。
- 44、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可合作性和可 cooperation。
- 45、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可沟通性和可 communication。
- 46、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可协调性和可 coordination。
- 47、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可一致性和可 consistency。
- 48、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可统一性和可 uniformity。
- 49、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可标准化和可 standardization。
- 50、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可规范性和可 regulation。
- 51、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可约束性和可 constraint。
- 52、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可限制性和可 limitation。
- 53、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可控制性和可 control。
- 54、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可管理性和可 management。
- 55、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可组织性和可 organization。
- 56、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可计划性和可 planning。
- 57、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可实施性和可 implementation。
- 58、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可执行性和可 execution。
- 59、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可操作性和可 operation。
- 60、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可应用性和可 application。
- 61、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可推广性和可 promotion。
- 62、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可普及性和可 popularization。
- 63、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可传播性和可 dissemination。
- 64、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可交流性和可 exchange。
- 65、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可互动性和可 interaction。
- 66、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可参与性和可 participation。
- 67、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可合作性和可 cooperation。
- 68、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可沟通性和可 communication。
- 69、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可协调性和可 coordination。
- 70、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可一致性和可 consistency。
- 71、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可统一性和可 uniformity。
- 72、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可标准化和可 standardization。
- 73、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可规范性和可 regulation。
- 74、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可约束性和可 constraint。
- 75、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可限制性和可 limitation。
- 76、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可控制性和可 control。
- 77、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可管理性和可 management。
- 78、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可组织性和可 organization。
- 79、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可计划性和可 planning。
- 80、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可实施性和可 implementation。
- 81、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可执行性和可 execution。
- 82、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可操作性和可 operation。
- 83、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可应用性和可 application。
- 84、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可推广性和可 promotion。
- 85、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可普及性和可 popularization。
- 86、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可传播性和可 dissemination。
- 87、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可交流性和可 exchange。
- 88、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可互动性和可 interaction。
- 89、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可参与性和可 participation。
- 90、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可合作性和可 cooperation。
- 91、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可沟通性和可 communication。
- 92、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可协调性和可 coordination。
- 93、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可一致性和可 consistency。
- 94、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可统一性和可 uniformity。
- 95、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可标准化和可 standardization。
- 96、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可规范性和可 regulation。
- 97、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可约束性和可 constraint。
- 98、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可限制性和可 limitation。
- 99、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可控制性和可 control。
- 100、 本检测报告的有效性依赖于委托方提供的样品的可管理性和可 management。

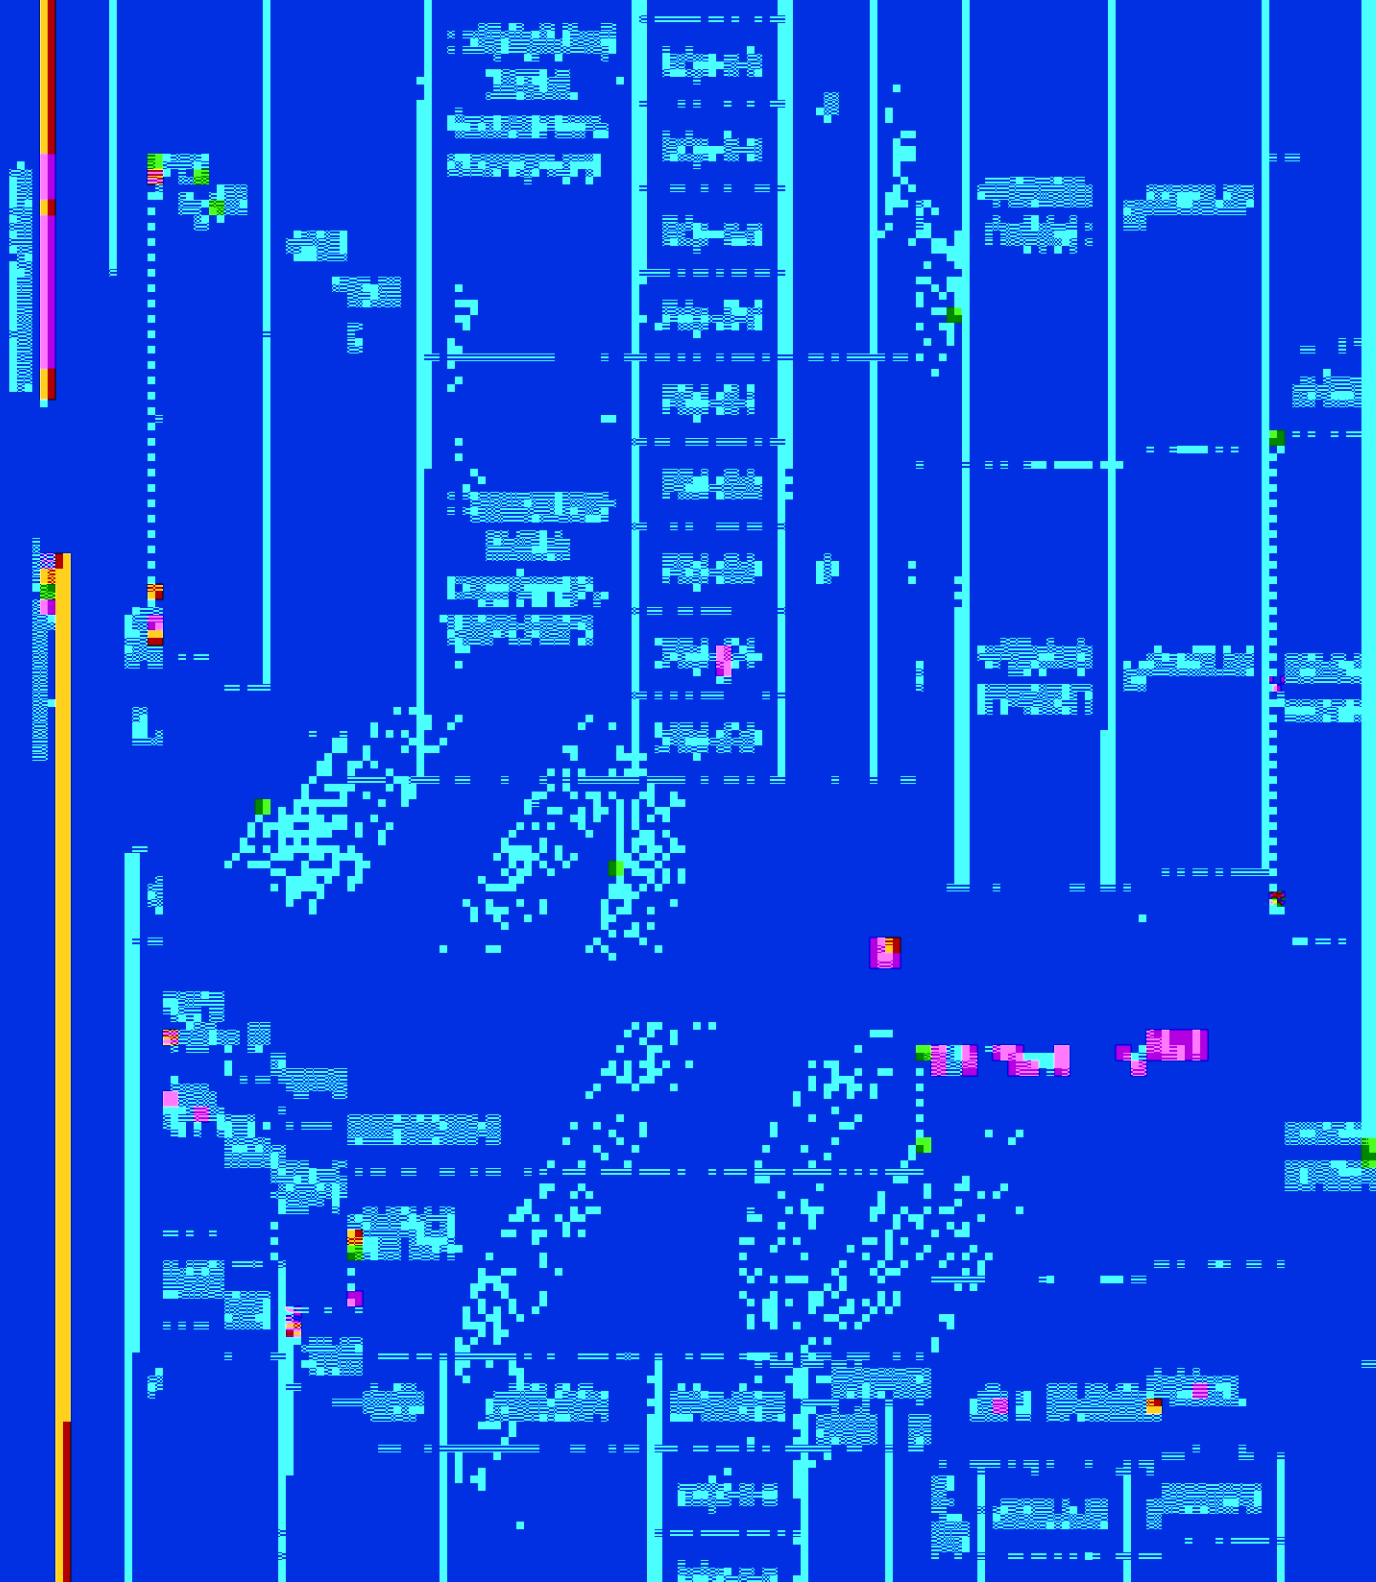

NO.1

产品状态描述

膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。
膜、不锈钢托网、密封铝圈密	存完好无破损。

NO.2

托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密
托网、密封铝圈密

仪器型号/编号	检测人员	最低检出限
FA2004X TT-FX0033	桑拉宗	1.0mg/m ³
ZR-3260/ Ti-XC0116	欧珠 次仁	3mg/m ³
ZR-3260/ TT-XC0116	欧珠 次仁	3mg/m ³
ZR-3260/ TT-XC0116	欧珠 次仁	-

靴衣
鞋设备

报告
Report

2.生产现场编号、检测

NO.1

	mg/m ³ ;
	0%;
	25%;
	20%;
	过±6μmol/mol (17mg/m ³) ;
	ng/m ³) 时, 相对误差不超过±30%;
	mg/m ³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol
	15%。

NO.2

考核指标

氨氧化物排放浓度；

排放浓度 $\leq 41\text{mg m}^{-3}$ 时，绝对误差不超过 $\pm 6\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 12mg m^{-3} ）；

排放浓度 $> 41\text{mg m}^{-3}$ 且 $\leq 50\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 103mg m^{-3} ）时，相对误差不超过

$\pm 30\%$ ；

排放浓度 $> 250\mu\text{mol mol}^{-1}$ （ 513mg m^{-3} ）时，绝对误差不超过

$\pm 20\mu\text{mol/mol}$

排放浓度 $> 513\text{mg m}^{-3}$ 时，相对准确度 $\leq 15\%$ 。

④ $\leq 15\%$ ；

⑤ 不超过 $\pm 1.0\%$ 。

⑥ 不超过 $\pm 10\%$ ；

⑦ 不超过 $\pm 12\%$ 。

⑧ 绝对误差不超过 $\pm 25\%$ ；

⑨ 绝对误差不超过 $\pm 1.5\%$ 。

NO.1	
生产负荷	
100%	
52.70%	

[illegible]

数据表
绝对误差





绝对误差报表

测量单位	
测试地点	藏日塔喇高我
测试位置	线密头
生产厂	北京雪迪龙科
型号/编号	SCS-900C
MS 原理	电化
S 法 (B)	数据对差
19.77	-0.3
19.77	0.3
19.77	0.7
19.77	-0.7
19.77	-0.3
19.77	0.3
19.77	-0.3
0.03	
0.41	
±0.4	
0.02	

NO.2

水泥有限
监测点
股份有限公司
1-8-0932
d=3-A)

0.1

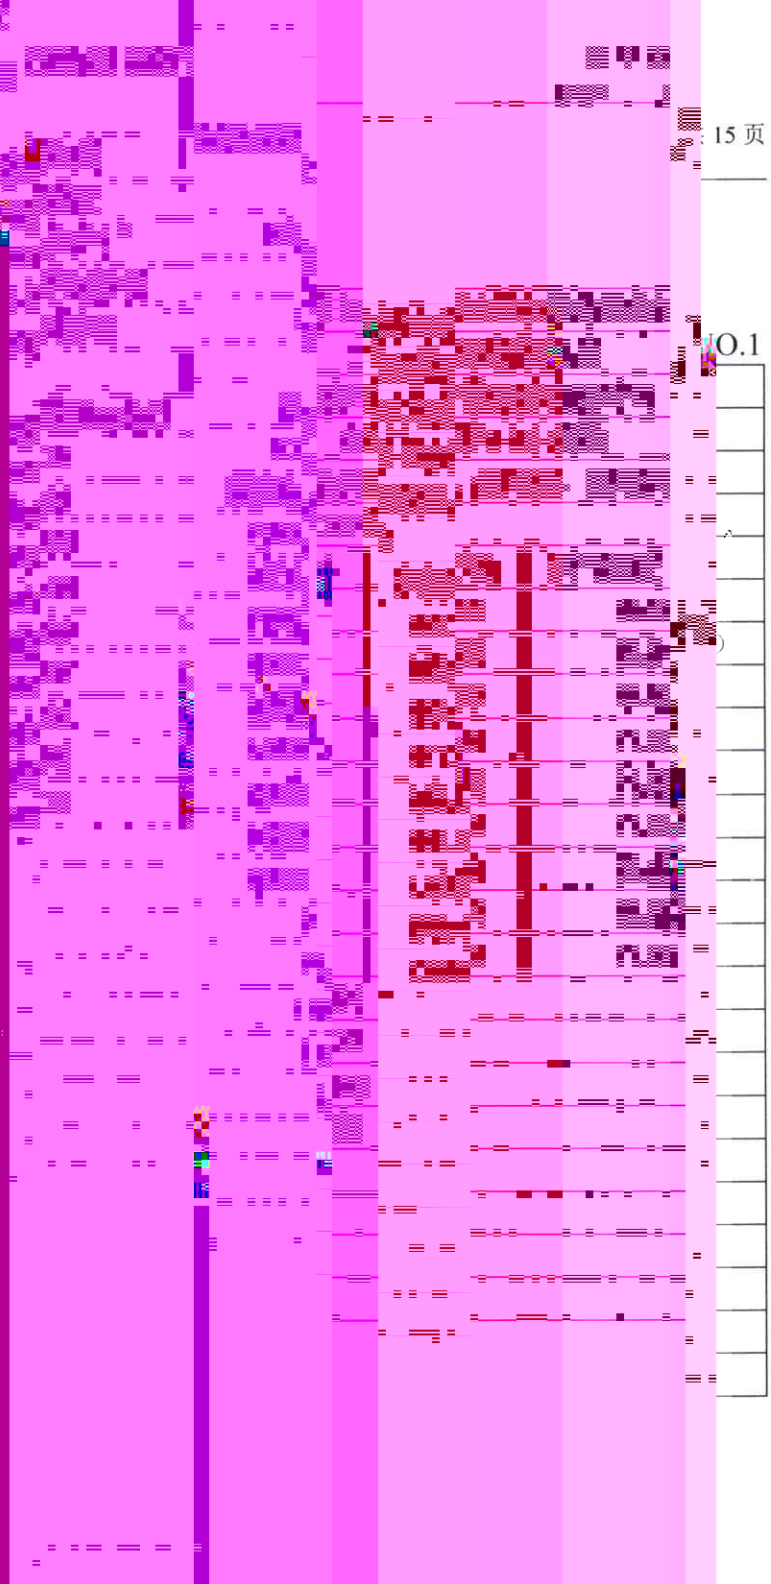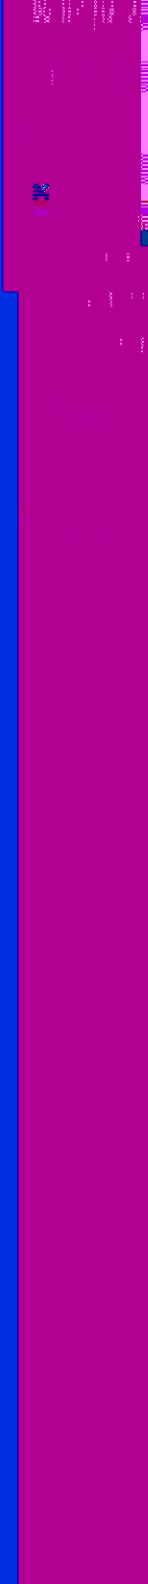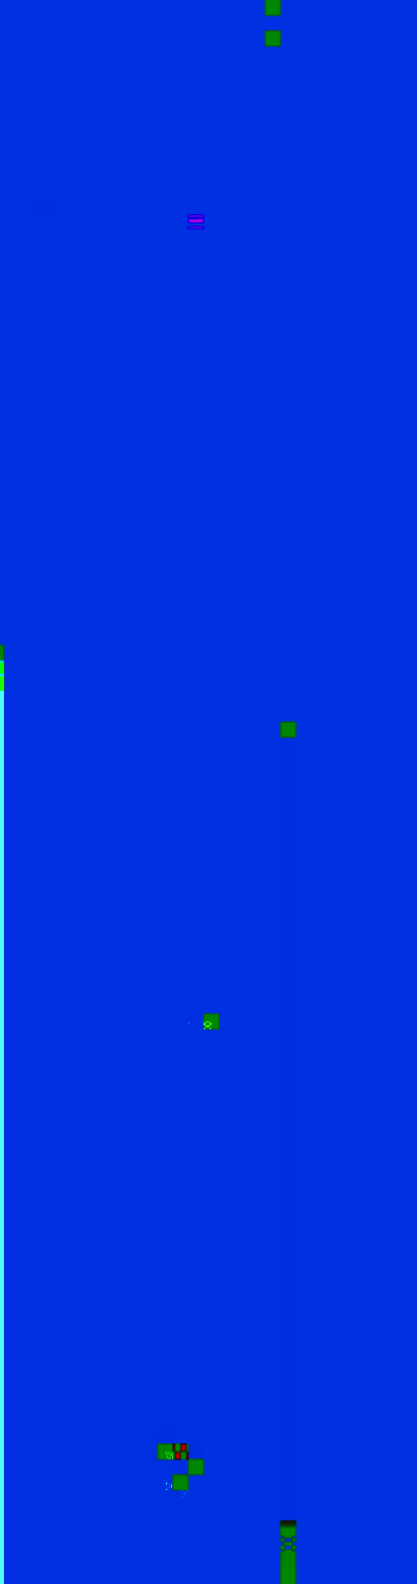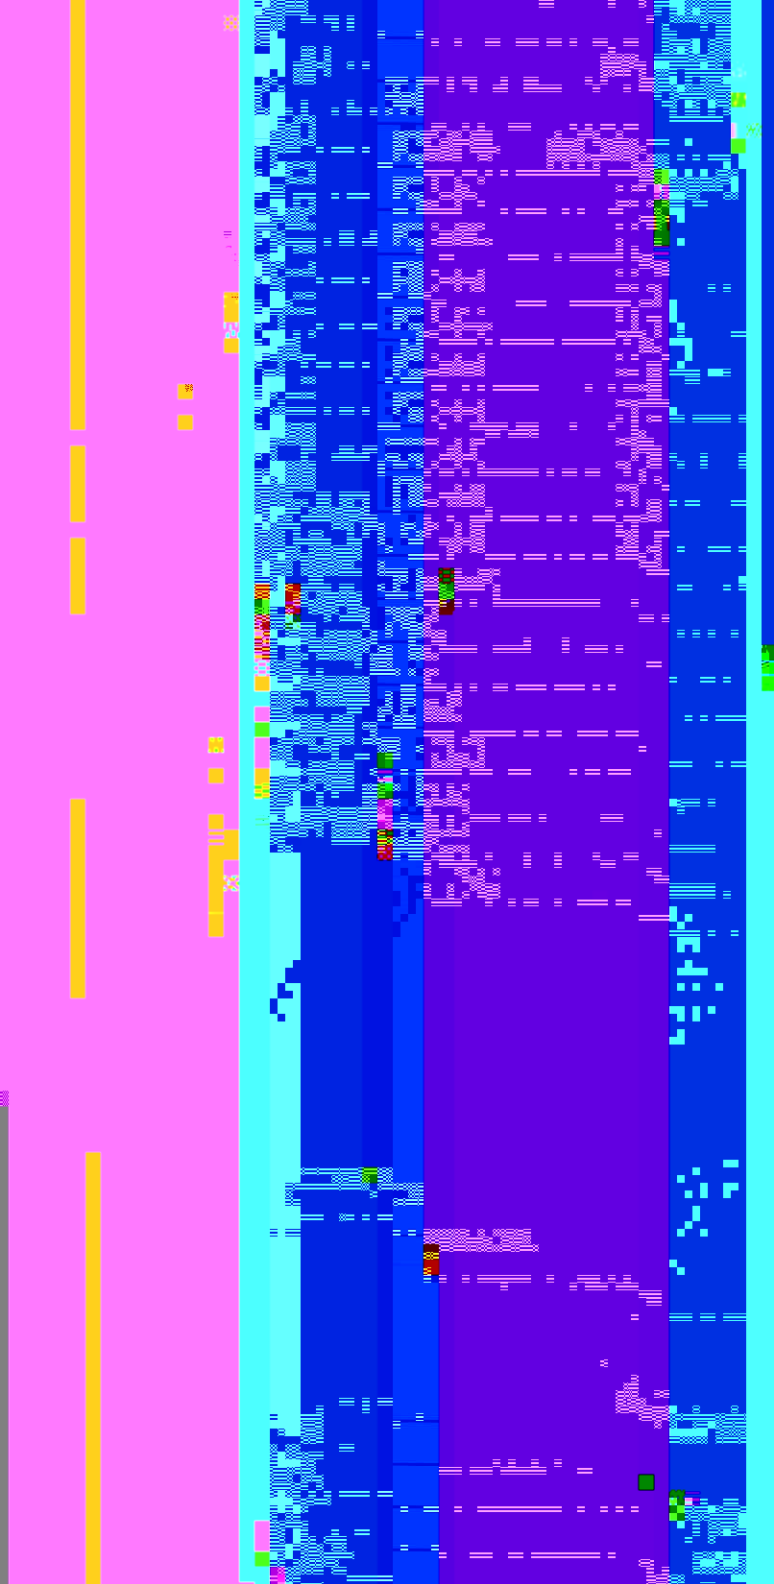

NO.2

西藏	喀则高新	%
二	雪莲水泥有限公司	
线	比对监测点	
窑	技股份有限公司	
尾	限公司	
雪	SCS-900C/F1-L8-09	
迪	电化	32
龙	化学法	
科	数据对差 (d=B-A)	
	-0.20	
	-0.14	
	-0.35	
	-0.33	
	-0.40	
	-0.59	
	-0.32	
	-0.32	
	-0.32	
	-0.03	

1. 检测点
mg/m³

2. 检测点名称
新雪莲水泥有限公司 NO.3

3. 检测点位置
尾比对监测点

4. 检测点编号
SC-S-001

5. 检测点地址
科技股份有限公司

6. 检测点坐标
0C/F1-L8-0932

7. 检测方法
数据对比分散红外法

8. 检测时间
差 (d=B-A)

9. 检测结果
-0.53

10. 检测结果
0.39

11. 检测结果
-0.56

12. 检测结果
-0.21

13. 检测结果
0.32

14. 检测结果
-0.31

15. 检测结果
0.22

16. 检测结果
0.55

17. 检测结果
0.53

18. 检测结果
0.03

误差/绝对误差报表

计量单位

测试地点

测试位置

EMS 生产厂

MS 型号/编号

EMS 原理

MS 法 (B)

312.29

355.14

321.42

360.10

322.48

331.13

335.82

344.38

336.80

335.51

0.21

mg/m³

NO.4

西藏日喀则高新雪莲水泥

二线窑尾比对监测有限公司

北京雪迪龙科技股份有限公司

SCS-900C/F1-L8-09有限公司

非分散红外法 32

数据对差 (d=B-A)

0.39

0.44

-0.38

0.80

-0.22

0.53

-0.18

0.48

-0.30

0.21

型号

ZR-
STT-X

限公司二
到 HJ 75-2

污染源

器型号

100FT 型

值 单
mg

第 14 页 共 15 页
page of

: 20

25 年 03 月 26 日

NO.1

制造单位

北京雪迪龙科技
股份有限公司

结果评定

合格

合格

合格

合格

合格

合格

合格

方法依据

HJ836-2017



HJ57-2017


HJ 693-2014

氧化、
《考物、流速、烟温、
核指标要求。

%) 样后	允许相对误差 (%)	结果评价
	±5	合格
0.1		合格
0.0		合格

硫、氮氧化物和氧气标准气体对烟气

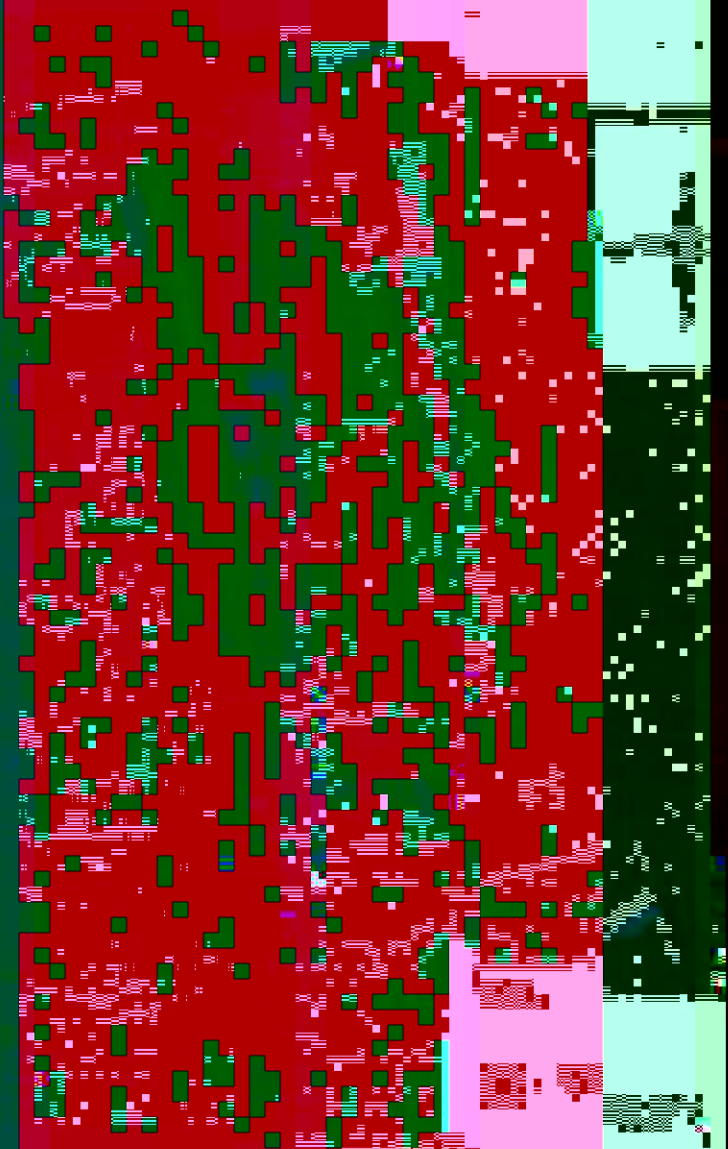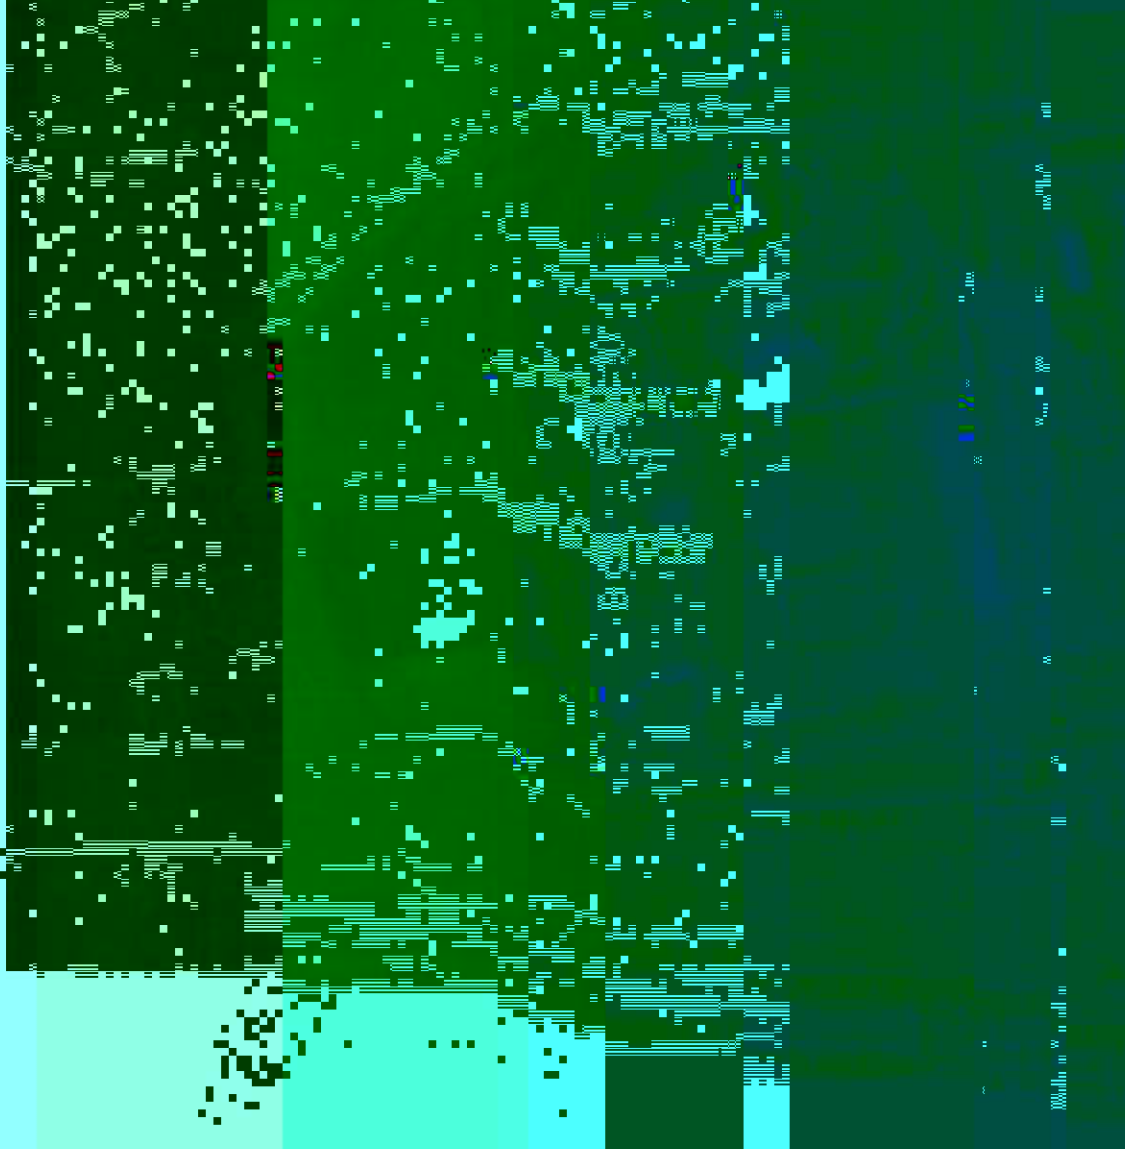


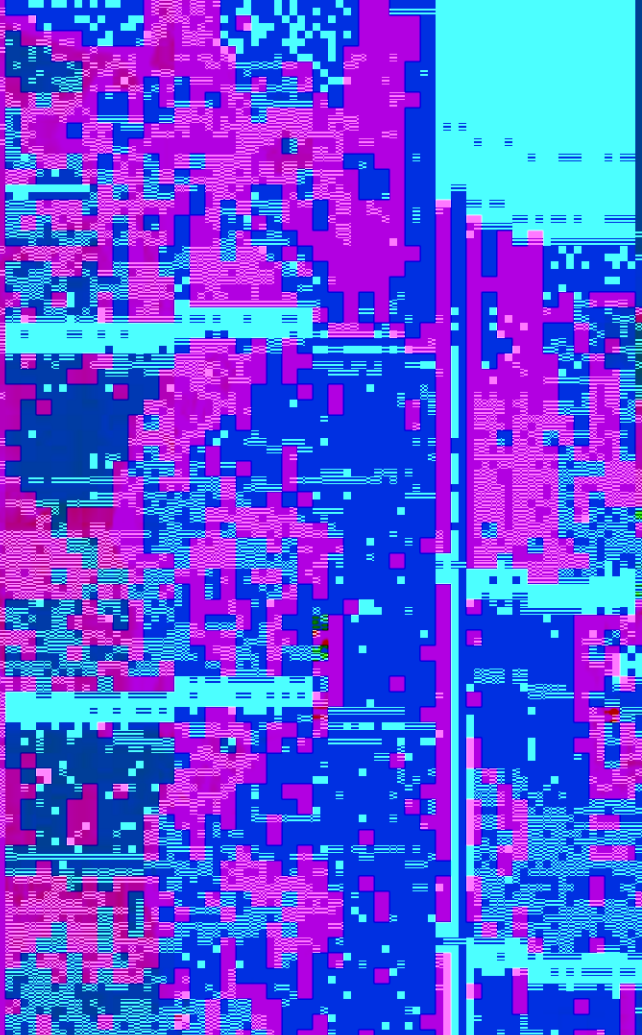

片：0324005-2



日喀则市萨迦县
限公司
6:17:54.20
市高新普连水泥有限公司
3线窑尾检测

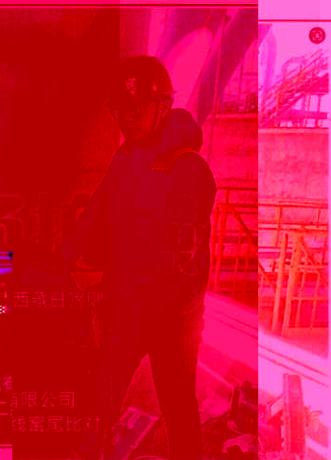

西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
3线窑尾比对



经度: 88.2111
纬度: 29.1322
地址: 西藏自治区日喀则市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
时间: 2025-03-26 18:45:21
海拔: 3931.4米
备注: 西藏日喀则市高新普连水泥有限公司
2025年第一季度环境常规检测 二线窑尾比对
监测点(第八次)



经度: 88.2111
纬度: 29.1322
地址: 西藏自治区日喀则市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
时间: 2025-03-26 19:03:55
海拔: 3931.4米
备注: 西藏日喀则市高新普连水泥有限公司
2025年第一季度环境常规检测 二线窑尾比对
监测点(第九次)



西藏日喀则
市萨迦县 西藏日喀则
市高新普连水泥有限公司
3线窑尾比对