

機測報告

測驗日期: 2022-09-26 09:00:00 ~ 2022-09-26 10:00:00

測驗科目: 國語 (國文) 測驗科目: 國語 (國文)

測驗時間: 2022-09-26 09:00:00 ~ 2022-09-26 10:00:00

測驗地點: 國語 (國文)

測驗科目: 國語 (國文)

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目

測驗科目





THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE

THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE

THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE

THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE

THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE



THE FUTURE OF BUSINESS IS HERE

NO.2

人员	采样时间	分析时间	样品状态描述
王仁	2025.09.14	2025.09.22 2025.09.24	前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
			前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
			前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
			前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
			前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。
			前弯管、玻璃纤维滤膜、不锈钢托网、密封铝圈密封保存完好无破损。

采样点位	样品编号	采样频次		采样人
		次数	天数	
2013(30°)	1Q1-6-3	9	1	王仁
	1Q1-6-4			
	1Q1-6-5			
	1Q1-6-6			
	1Q1-6-7			
	1Q1-6-8			
2013(30°)	1Q1-6-9			

仪器	型号/编号	分析人员	最低检出限
FJA2004X STT-3 SFX0083		古桑拉宗	1.0mg m ³
ZR-3260/ STT-XC0116		旦真次旺 旦增次仁	3mg m ³
ZR-3260/ STT-XC0116		旦真次旺 旦增次仁	3mg m ³
ZR-3260/ STT-XC0116		旦真次旺 旦增次仁 平措欧珠 边巴真吉	-

NO.1	
考核指标	
颗粒物排放浓度：	
绝对误差不得超过±5mg/m³；	
1mg/m³ 时，绝对误差不得超过±6mg/m³；	
2mg/m³ 时，相对误差不得超过±30%；	
3mg/m³ 时，相对误差不得超过±25%；	
4mg/m³ 时，相对误差不得超过±20%；	
相对误差不得超过±15%。	
氧化硫排放浓度：	
7mg/m³) 时，绝对误差不得超过±6μmol/mol（17mg/m³）；	
排放浓度<50μmol/mol（143mg/m³）时，相对误差不得超过±30%；	
排放浓度<250μmol/mol（715mg/m³）时，绝对误差不得超过±20μmol/mol	
715mg/m³) 时，相对准确度±5%。	

NO.2

考核指标

1.氮氧化物排放浓度:

≤ 20μmol

mol (4

mol (1
g/m³);

≤ 250μ

寸, 相对

寸, 绝对

差不超过

时, 相

时, 相

差>5.0%

差≤5.0%

不超过±6μmol/mol (12mg/m³);

(10, ng/m³) 时, 相对误差不超过±30%;

3) ≤排放浓度<250μmol/mol (513mg/m³) 时, 绝对误差不超过±20μmol/mol

寸, 相对准确度≤15%。

≤15%;

超过±1.0%。

不超过±10%;

不超过±12%。

对误差不超过±25%;

*对误差不超过±1.5%。

企业工况一览表

生产能力	监测期间运行情况	生产负荷
8.93t/d	正常	53.09%
6.34t/d	正常	66.87%
1.17t/d	正常	54.03%
8.14t/d	正常	41.23%
9.02t/d	正常	49.53%
8.35t/d	正常	71.06%
1.72t/d	正常	39.88%
6.42t/d	正常	71.32%

NO.1

报表

温度 CEMS 比对数据报

表


测试地点	西藏			NO.1
测试位置	藏日喀则高新雪莲水泥有限公司			
CEMS 生产厂	二线窑头比对监测点			
CEMS 型号/编号	北京雪迪龙科技股份有限公司			
CEMS 原理	SCS-900C/F1-L8-0932			
		散射法		
		CEMS 法		
颗粒物测定(mg/m³)	流速(m/s)	烟温(°C)	烟气湿度 (%)	
23	14.6	64.5	2.8	
17	14.5	65.4	2.8	
21	14.0	63.8	2.9	
19	14.0	65.9	2.9	
16	14.2	70.7	3.0	
15	14.7	78.8	3.0	
		18.5		
		14.3		
		68.2		
		2.90		
1.5				
-2.7				
-0.4				
0.12				

表

NO.2	
0.0	
西藏日喀则高新二线城市	谢宁莲水泥有限公司
北京雪迪龙	头比对监测点
SCS-900	科技股份有限公司
DC F1-L8-0932	
数据对比	相对误差 (d=B-A)
	0.2
	0.3
	0.2
	0.1
	0.3
	0.1
	0.17

CEMS 比对监测数据并
污染物 CEMS 相对误差


[illegible]

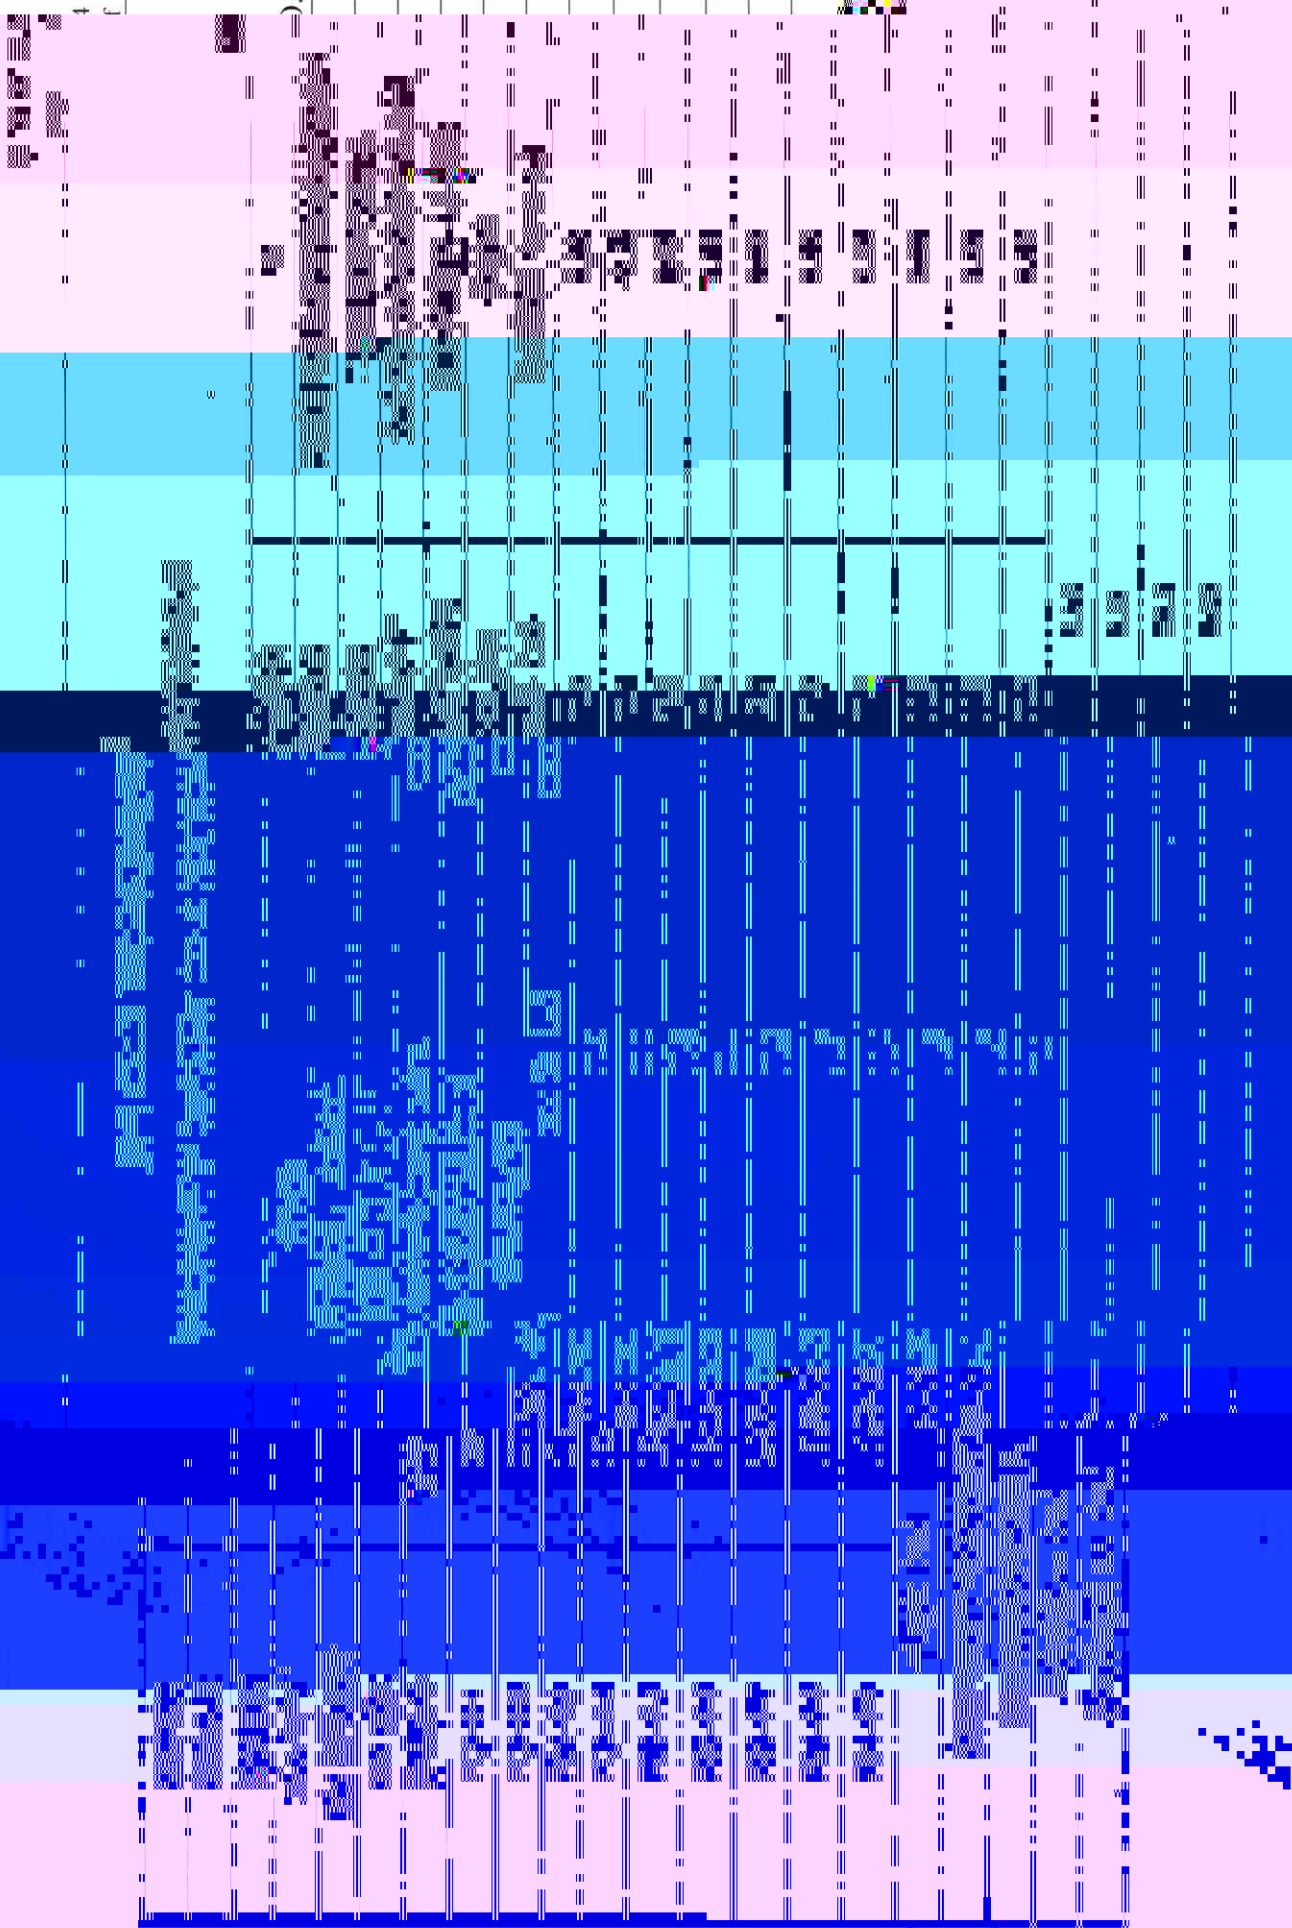

N(3)											

1

2

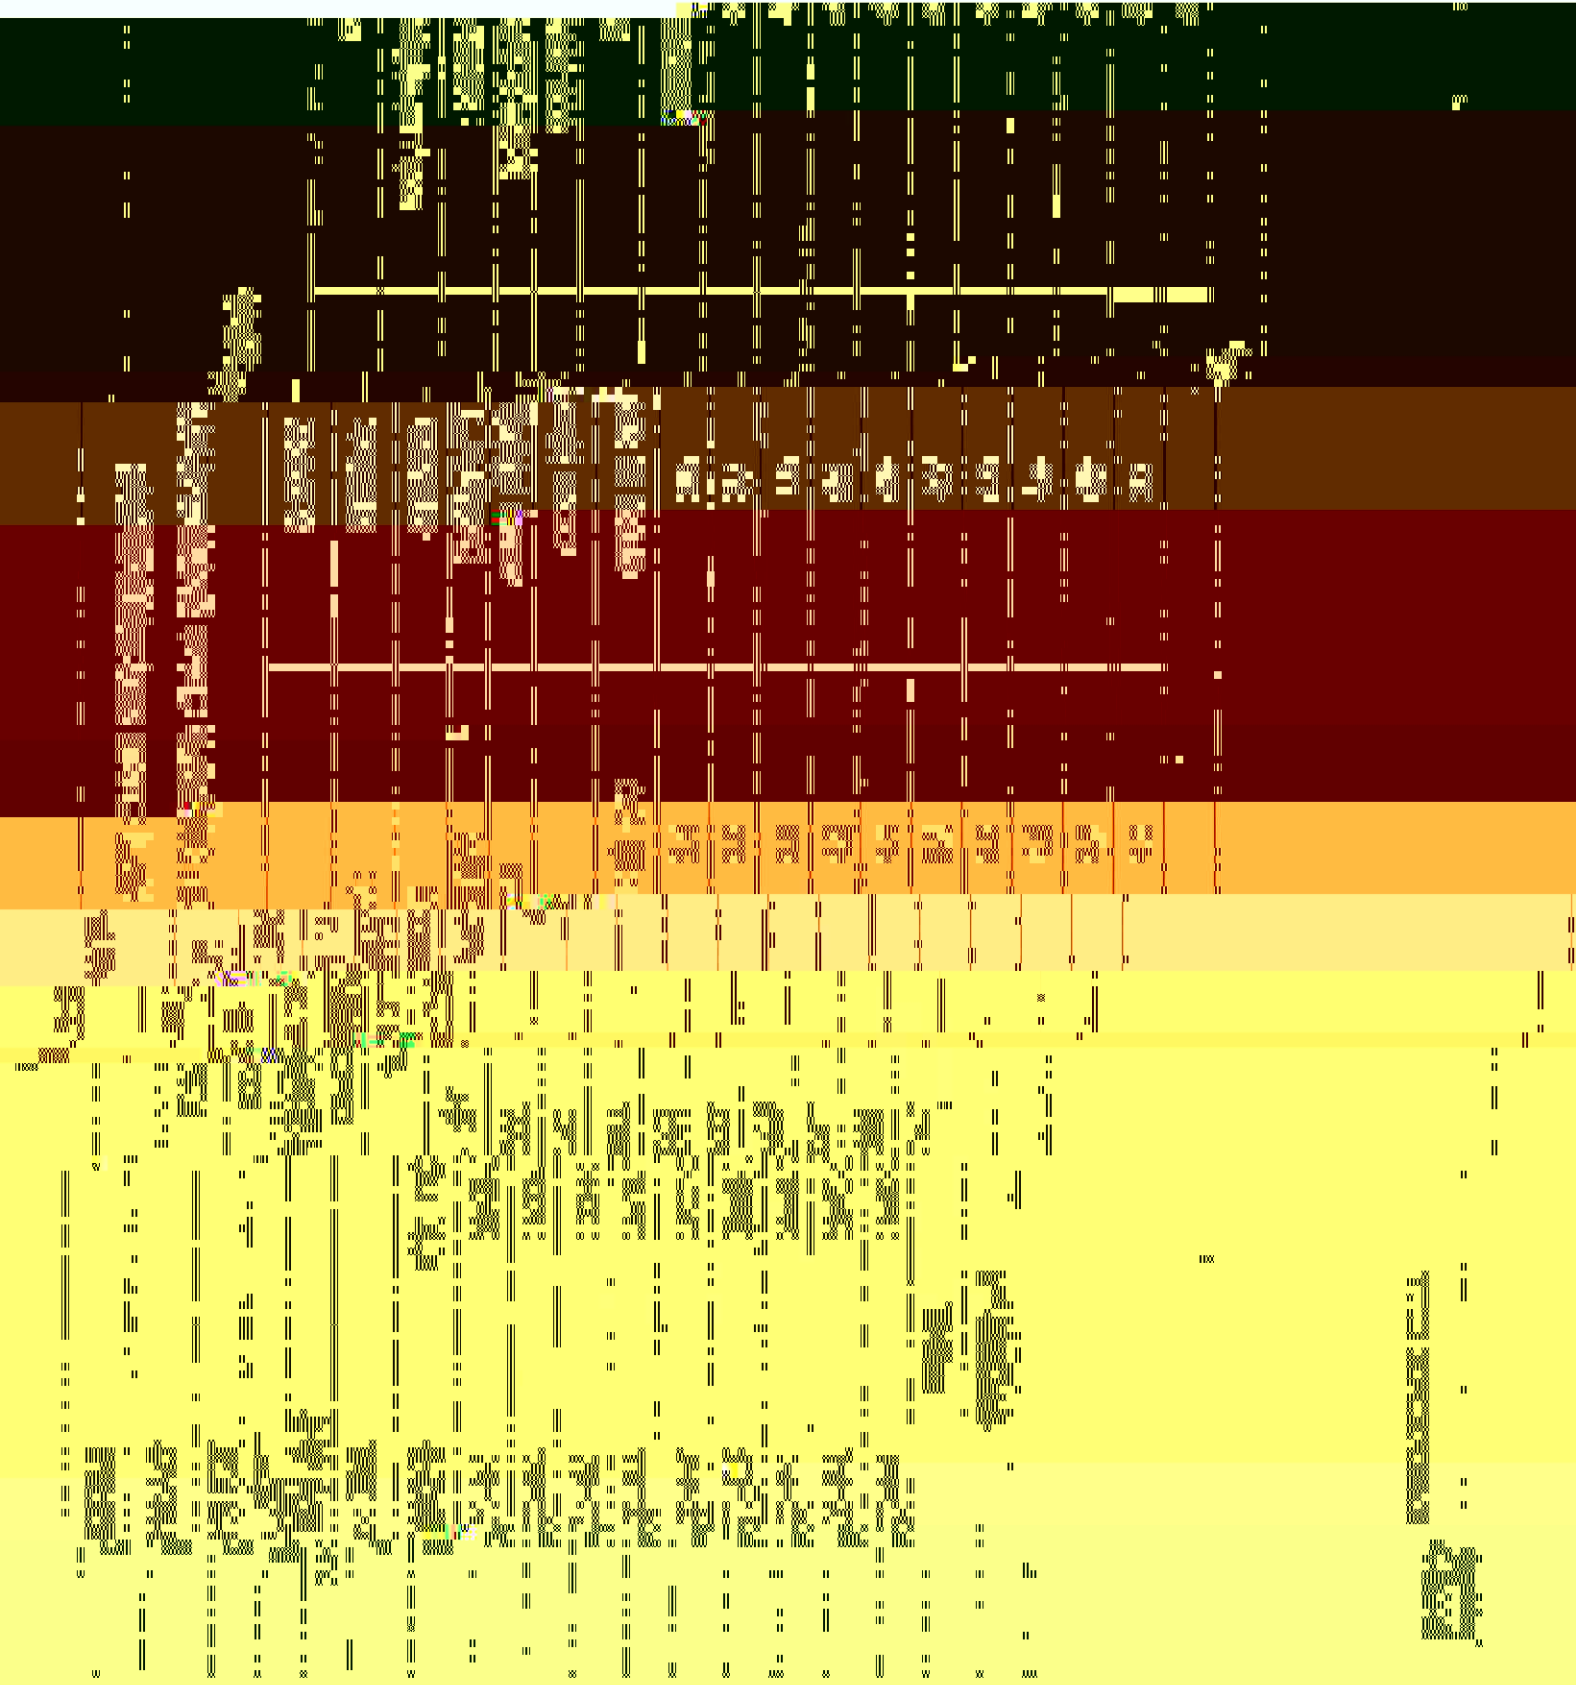

NO.1

新雪莲水泥有限公司	
毛比对监测点	
科技股份有限公司	
JC/F1-L8-0932	
散射法	

气(°C)	烟气湿度 (%)
3.9	11.8
3.1	13.2
7.2	13.1
7.5	13.3
2.1	12.8
7.2	11.7
8.7	11.6
6.3	11.4
7.2	11.5

NO.4

mg/m ³	
高斯宁连水泥有限公司	
裕儿比对照测点	
龙科技股份有限公司	
00C F1-L8-0932	
散射法	
寸差 (d=B-A)	
-1.3	
1.7	
-0.5	
0.6	
1.5	
-1.2	
-2.1	
0.5	
1.4	
0.1	

测试日期: 2025年09月15日
NO.1

制造单位	北 京 博 瑞 思 迪 龙 科 技 有 限 公 司
结果评定	合格
	合格
	合格
	合格
	合格
方法依据	GB/T 16157-1996
电位电 解 法	颗粒物、流速、烟温、烟湿度、含氧量比
考核指 标 要求。	

标准限值

差≤±6 mg/m³
值不超过±10%
误差≤±3℃
误差≤±1.5%
准确度≤15%

电位电 解 法

颗粒物、流速、烟温、烟湿度、含氧量比

考核指 标 要求。

日期

测试

1.5m

2.0m

3.0m

4.0m

5.0m

6.0m

7.0m

8.0m

9.0m

10.0m

11.0m

12.0m

13.0m

14.0m

15.0m

16.0m

17.0m

烟气 CEMS 比对监测结果表

EMS 主要仪器型号		仪器原理	测试日期:
		散射法	
比对检测结果			
3	绝对误差	-0.62mg/m ³	值
	相对误差	-0.42%	mg/m ³
	绝对误差	-0.73℃	±12%
	绝对误差	-0.07%	3℃
	相对准确度	1.00%	±1.5%
1号	仪器原理		15%
50/0116	皮托管平行测速采样法、重量法、气		
头比对监测点 CEMS 09 月 26 日比对监测，颗		解法	
SO ₂ 、NO _x 、颗粒物 1 日放连续监测技术规范》		标准、方	
		标准要求	

颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
流速
烟气油
含氧
烟
参比
皮托管平
采样
定电位电
结

报告编号：XZ
ReportNo

测试点

项

第 22 页 page	共 24 页 of	试日期：2025 年 09 月 14 日	NO.1	制造单位 北京雪迪龙科技股 限公司	结果评定 合格	值 6mg/m³	份有
					合格	7mg/m³	
					合格	1mg/m³	
					合格	过±10%	
					合格	过±25%	
					合格	≤15%	
					合格	±3℃	
				方法依据			
				GB/T16157-1996		解法	
				HJ57-2017		气体	
				HJ 693-2014		二氧化硫、氮氧化物、流速、烟	
						测技术规范》考核指标要求。	
							温、

标准，采用国家二氧化硫、氮氧化物和氧气标准气体对烟气

果 采样后	相对误差 (%)		允许 相对误差 (%)	结果评价
	采样前	采样后		
183	-0.5	-1.1	±5	合格
203	1.0	-0.5		合格
154	-1.3	-1.9		合格

